


NEXIS® MIS TRAY OVERHEAD GUIDE

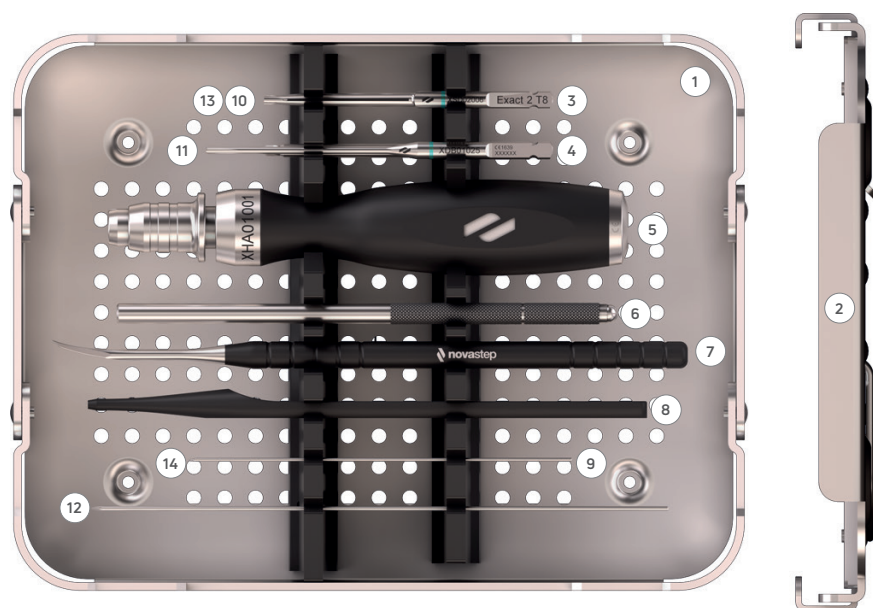

INSTRUMENTATION NEXIS® MIS

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
1	BOITE	ACC1018P0001	1
2	COUVERCLE	ACC1018P0002	1
3	EMBOUT AO EXACT2-T8	XSD02006	2
4	FRAISE À CHAMBRER Ø 2,8	XRE01024	1
5	MANCHE AO	XHA01001	1
6	MANCHE DE BEAVER ⁽¹⁾	-	1
7	RUGINE SIMPLE EMBOUT	XMS01011	1
8	RÉGLET LG 100/150	XGA01013	1
9	BROCHE Ø1,2 LG 100 TR/RD ⁽²⁾	-	5

⁽¹⁾ Référence SF13 vendue séparément - disponibilité en fonction de votre marché.

⁽²⁾ Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-100) ou broche Novastep® (CKW01014) disponibles en fonction de votre marché.

OPTION - INSTRUMENTATION NEXIS® MIS

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
10	EMBOUT DE RETRAIT AO EXACT2-T8	XSD02007	1
11	FORET CANULÉ Ø1,9	XDB01025	1
12	BROCHE Ø1,2 LG 150 TR/RD ⁽³⁾	-	5

⁽³⁾ Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-150) ou broche Novastep® (CKW01015) disponibles en fonction de votre marché.

OPTION - INSTRUMENTATION NEXIS® Ø2,3

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
13	EMBOUT AO T7	XSD01001	2
14	BROCHE Ø1,2 LG 150 TR/RD ⁽⁴⁾	-	5

⁽⁴⁾ Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-09-100) ou broche Novastep® (CKW01008) disponibles en fonction de votre marché.



T +33 (0) 2 99 33 86 50 F +33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant: Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life
Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

RÉFÉRENCE: NEX-MIS-TL-ED4-06-25-FR